ÜRÜN KATALOĞU

makrolab

Makrolab Tıbbi Ürünler A.Ş.

www.makrolabkonya.com.tr

MAKROLAB ÜRÜN KATALOĞU

makrolab

Makrolab Tıbbi Ürünler A.Ş.

Vacufine | Urifine

www.makrolabkonya.com.tr

Her örnek bir hayattır,

Hassasiyetimizle Kor yoruz.

makrolab

Makrolab Tıbbi Ürünler A.Ş.

Vacufine | Urifine

www.makrolabkonya.com.tr

ÜRÜN KATALOĞU

İÇİNDEKİLER

09 **Vacufine Tüpleriyle** Kan Alma Uygulaması

13 VACUFINE **SERUM AYIRICI TÜPLER**

14 VACUFINE **SERUM TÜPLERİ**

15 VACUFINE **EDTA TÜPLERİ**

16 VACUFINE **SİTRATLI TÜPLERİ**

17 VACUFINE **SEDİMENTASYON TÜPLERİ**

18 VACUFINE **LİTYUM/SODYUM HEPARİN TÜPLERİ**

19 VACUFINE **PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ**

20 VACUFINE **PLAZMA PREPERASYON TÜPLERİ**

21 VACUFINE **GLUKOZ TÜPLERİ**

24 VACUFINE **PLAZMA PREPERASYON ve PRP TÜPLERİ**

25 VACUFINE **PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ**

28 URİFİNE **İDRAR TAŞIMAKAPLARI**

29 URİFİNE **GAİTA BALGAM TAŞIMA KAPLARI**

30 URİFİNE **VAKUMLU İDRAR TÜPLERİ**

31 URİFİNE **ENTEGRE İDRAR TAŞIMA KAPLARI**

32 **YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR** PERDE SİSTEMİ

33 **ZEBRA PERDE**
STOR PERDE

makrolab

Makrolab Tıbbi Ürünler A.Ş.

Her örnek bir hayattır,

Hassasiyetimizle Koruyoruz.

Vacufine | **Urifine**

www.**makrolabkonya**.com.tr

KURUMSAL

MAKROLAB Tıbbi Ürünler A.Ş.
2013 yılından bu yana sağlık ürünleri sektöründe üretim hizmeti vermektedir. Class 100,000 üretim sahasında son teknoloji ile donatılmış AR-GE laboratuvarlarında tam otomatik montaj makineleri ve tecrübeli kadrosu ile iyi Üretim Uygulamaları Prensipleri çerçevesinde müşterilerine çözüm odaklı hizmet veren **MAKROLAB**, modern ekipmanları ile üretim yapmaktadır. **MAKROLAB** üretime başladığında üretim gamında idrar kapları, tek kullanımlık idrar tüpleri ve tıbbi atık kutusu ürünleri bulunmaktaydı. 2019 yılı yatırımları ile birlikte **MAKROLAB;**

VACUFINE markası ile Vakumlu Numune
Toplama Tüpleri, Holder, Kan Alma İğneleri ve Tıbbi Atık Kapları;

URIFINE markası ile Vakumsuz - Vakumlu Sistem İdrar ve Kaşıklı - Kaşıksız Gaita kapları, Tek Kullanımlık İdrar Tüpü, Vakumlu İdrar Toplama Tüpleri;

En iyiyi üretmek için çalışıyoruz

ÇÜNKÜ ÜRETMEYİ *Seviyoruz*

makrolab

Vacufine

	Tek kullanımlık
	Son kullanma tarihi
LOT	Lot numarası
REF	Referans Numarası
	Üretim tarihi
	Üretici
	Güneşten koruyunuz
	Ambalajı zarar görmüş ürünü kullanmayınız.
STERILE EO	Etilen oksit sterilizasyon
STERILE R	Radyasyon sterilizasyon
CE	CE işareti
IVD	In vitro tanı amaçlı tıbbi cihaz
	Kullanım talimatlarına başvurun
	Sıcaklık limiti
	Latex içermez
K2E	EDTA Dipotasyum Tuzu
K3E	EDTA Tripotasyum Tuzu
9NC	Trisodyum Sitrat 9:1
4NC	Trisodyum Sitrat 4:1
FE	Sodyum Fluorid/ EDTA
LFX	Sodyum Fluorid /Potasyum Oksalat
H	Lityum Heparin
NH	Sodyum Heparin
Z	Katkısız /Pihti Aktivatörü
CTAD	Tamponlanmış Sitrat 0.109 M
ACD-A	ACD Solüsyon A
ACD-B	ACD Solüsyon B
TBT	Trombin Bazlı Tüp

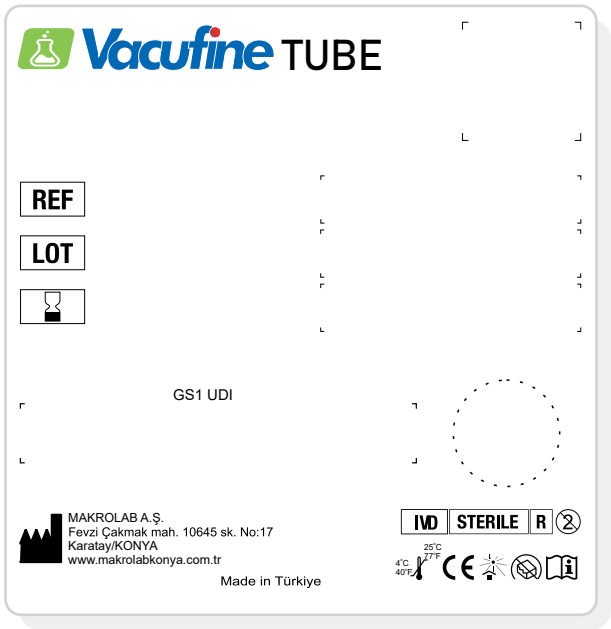

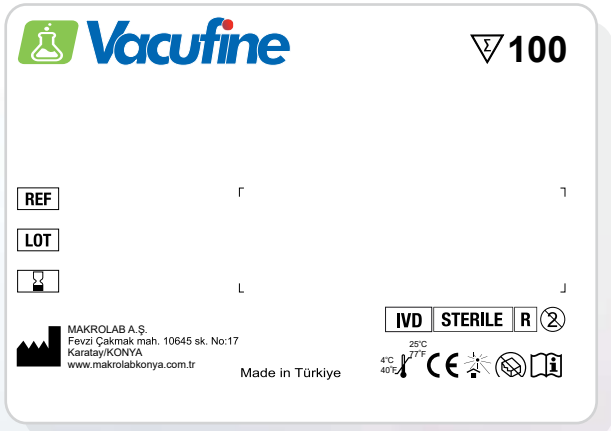

Vacufine Tüpleriyle Kan Alma Uygulaması

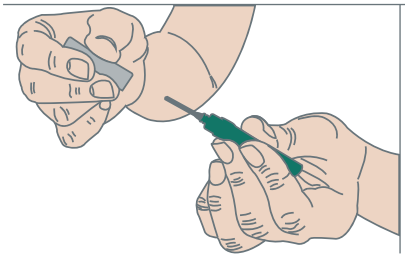

01

İğnenin sterilizasyon mührü gözle kontroledilir. Eğer mühür kırılmışsa kullanılmamalıdır. Eğer mühür kırılmamışsal yırtmak için çevirilir ve kapak atılır.

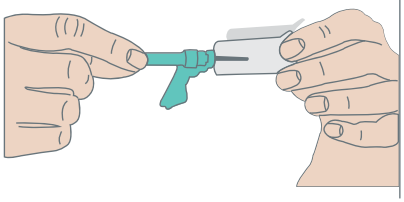

02

İğne holder'a vidalanarak yeşil güvenlik koruması geri çekilir. Renkli iğne koruması Çıkarılır.

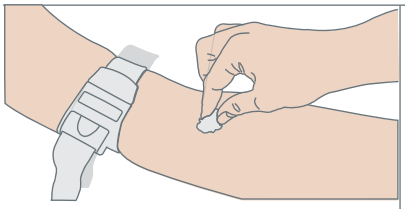

03

Turnike, istenilen kan alma bölgesinin 7,5-10 cm üzerinden uygulanır. Bölge dezenfekte edilir.

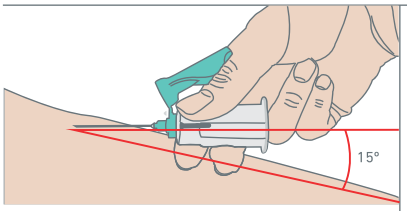

04

İğnenin kesik ucu güvenlik koruması ile aynı yöne bakacak şekilde hizalanır. Hastanın kolu yatay pozisyondayken iğneyi 15°'lik açıyla iterek kan alma bölgesine uygulanır.

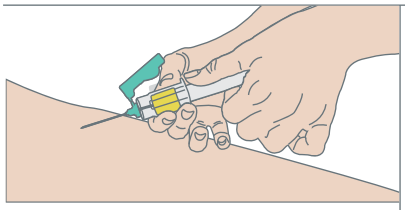

05

Tüp holder'a yerleştirilir. Holder baş ve işaret parmağın arasında tutulurken diğer elin baş parmağı tüpün dibinde olacak şekilde tüp holder'ın içine itinilir.

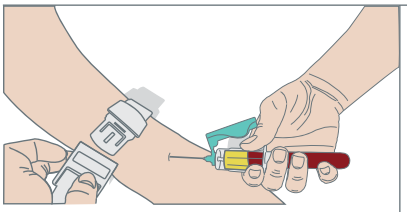

06

Turnike, tüpe kan akışı başlar başlamaz çözülür. Turnikenin 1 dakikadan daha uzun süre uygulanmaması gerekir.

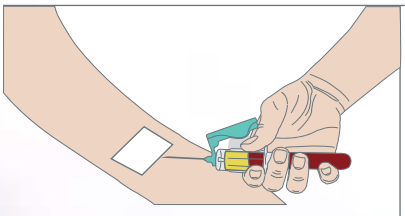

07

İğne nazikçe çıkarılırken kan alma bölgesinin üzeri gazlı bezle örtülür. Hematomu önlemek için bölgenin üstüne birkaç dakika basınç uygulanır.

08

Güvenlik koruması klik sesi duyulana kadar bastırılır. Holder ve iğne birbirinden ayrılmadan delici-kesici atık kutusuna atılır.

En iyiyi üretmek için çalışıyoruz

ÇÜNKÜ ÜRETMEYİ

Seviyoruz

Vacufine

VAKUMLU KAN ALMA TÜPLER

Vacufine tüpleri her biri değişik numune 5 hacmine sahip 3 ayrı ölçüde üretilmektedir. Tüpler kullanım amacına göre değişik hacimlere sahiptir. Vacufine tüpleri kırılmaz PET' den imal edilmiştir. Preanalitik kullanım dahil tüm kullanım metotlarında prob çarpmalarını engelleyen kapak 8 dizaynına sahiptir. Şeffaf, medikal etiket ve barkodlu etiket olarak 3 ayrı çeşidi bulunmaktadır.

- Serum Ayırıcı Tüpler
- Serum Tüpleri
- EDTA' lı Tüpler
- Sitratlı Tüpler
- Sedimentasyon Tüpleri
- Lityum/Sodyum Heparin Tüpler
- Plazma Preperasyon Tüpleri
- PRP Tüpleri
- Glikoz Tüpleri

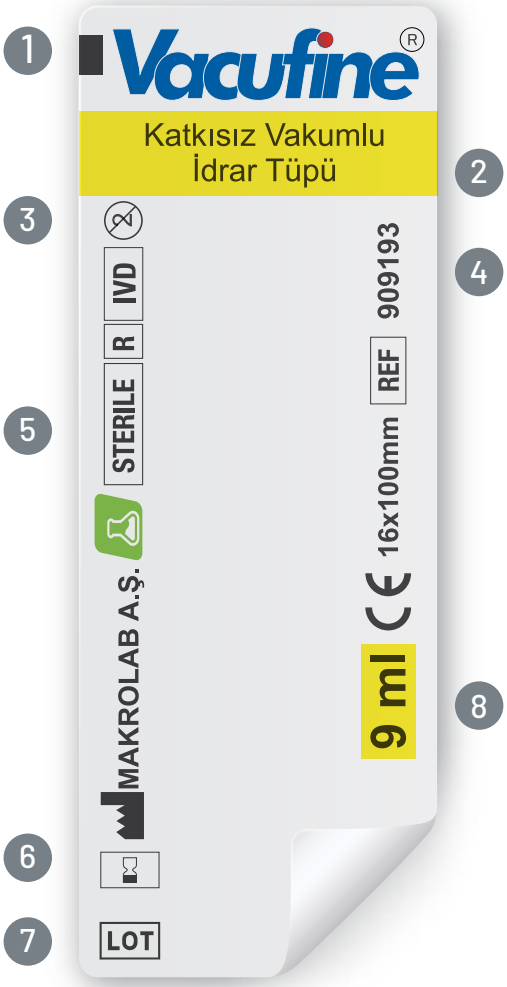

1. Dolum Seviyesi
2. Tüp Tipi
3. Tek Kullanımlık
4. Referans No.
5. Sterilizasyon Sembolü
6. Son Kullanma Tarihi
7. Lot Numarası
8. Hacim

SAĞLIĞINIZ
Bizimle Birlikte
Güvende

Vacufine | Urifine

www.makrolabkonya.com.tr

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

TÜPLER	RENK KODU	KATKI MADDESİ	KULLANILDIĞI TEST	MATERYAL
SERUM AYIRICI TÜP		PIHTI AKTİVATÖR+JEL	SERUM	PET
SERUM TÜP		PIHTI AKTİVATÖR	SERUM	PET
EDTA TÜPLERİ		K2EDTA, K3EDTA	TAM KAN	PET
SİTRATLI TÜPLER		TRİSODYUM SİTRAT	PLAZMA	PET
SEDİMENTASYON TÜPLERİ		PIHTI AKTİVATÖR + SODYUM SİTRAT	SERUM	PET
LİTYUM/SODYUM HEPARİN TÜPLERİ		LITYUM/SODYUM HEPARIN	PLAZMA	PET
PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ		LITYUM HEPARIN/JEL	PLAZMA	PET
PLAZMA PREPERASYON TÜPLERİ		K2EDTA/Jel	SEYRELTİLMİŞ PLAZMA	PET
GLUKOZ TÜPLERİ		NaF Na2EDTA	Laktat, glukoz ve HbA1c ölçümlerinin daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tercih edilir.	PET

Vacufine®

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

VACUFINE **SERUM AYIRICI** TÜPLER





Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
107125	2,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
107135	3,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
107235	3,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf
107140	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
108150	5	13x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
108250	5	13x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf
109185	8,5	16x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
109285	8,5	16x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Akrilik bazli jel ve pulvarizasyon tekniği ile kaplanarak kurutulmuş pıhtı aktivatörü içerir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Kullanımı: Klinik kimya, immünoloji, seroloji, protein elektroforezinde serum araştırmak.
- Pıhtılaşma süresi: 5 ila 30 dakika arası.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25°C)

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

VACUFINE
SERUM TÜPLERİ

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
407120	2	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
407220	2	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
407140	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
407240	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
408160	6	13x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
408260	6	13x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
409190	9	16x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile kaplanarak üretilmiştir. Pihti aktivatörü olarak silika içermektedir.
- Kullanımı: Klinik kimya, immünoloji, seroloji, protein elektroforezinde serum araştırmak.
- Pıhtılaşma süresi: 10 ila 30 dakika arası.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: ≤1300 x g (RCF) (10 dakika/25°C)

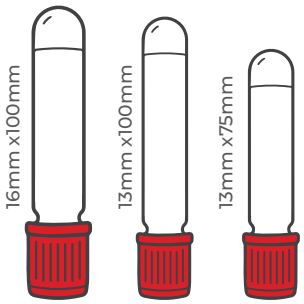



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Vacufine®

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

VACUFINE
EDTA TÜPLERİ

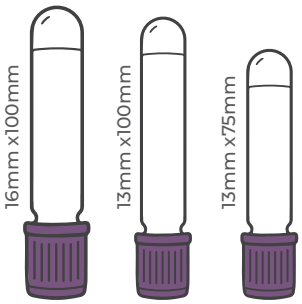



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
227120	2	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227220	2	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
227130	3	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227230	3	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
227140	4	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227240	4	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
228160	6	13x100	K2EDTA	PET	Kağıt
228260	6	13x100	K2EDTA	PET	Şeffaf
229190	9	16x100	K2EDTA	PET	Kağıt
237120	2	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237220	2	13x75	K3EDTA	PET	Şeffaf
237130	3	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237140	4	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237240	4	13x75	K3EDTA	PET	Şeffaf
237110	1	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- İçeriğinde bulunan sprey şeklinde püskürtülmüş EDTA kuvvetli bir şelatör olup kalsiyumu geri dönüşüms bağlamaktadır. Bunun yanında hematolojik analizlerde hücrelerin korunabilmesi ve analiz edilebilmesi için ortam sağlamaktadır.
- Tam kan sayımı ve hematolojinin diğer gruplarında kullanılabilir.
- Uluslararası uygulamalara uygun olarak şunları yapmak mümkündür:EDTA'nın iki seçeneğini kullanın:
  - EDTA K3;
  - EDTA K2;
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Tam Kan veya EDTA plazma örneği elde etmek için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

VACUFINE
SİTRATLI TÜPLERİ

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
327118	1,8	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya xxxxx	Kağıt
327218	1,8	13x75	0,109M, 3,2%	PET	Şeffaf
327127	2,7	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya Camx	Kağıt
327227	2,7	13x75	0,109M, 3,2%	PET	Şeffaf
387118	1,8	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP veya Cam	Kağıt
387127	2,7	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP	Kağıt
327145	4,5	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya Cam	Kağıt
387145	4,5	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP veya Cam	Kağıt
367127	2,7	13x75	0,109M, 3,2% CTAD	PET veya Cam	Kağıt

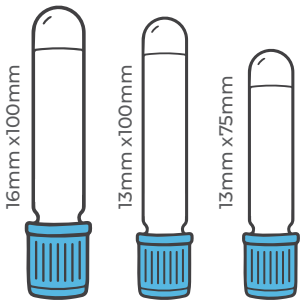



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- %3.2 (0.109 mol/L) veya %3.8 tamponlamış trisodyum sitrat çözeltisi içerir.
- 1 kısım sitrat çözeltisi 9 kısım tam kan numunesi ile karışmaktadır.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- CTAD Tüp:Tamponlanmış sitrat, teofilin, adenozin ve dipiridamol içerir. Piridamol, ışıktan etkilenebildiği için
- ışık görmeyen yerde muhafaza edilmelidir.
- Kullanımı: Hemostatik sistemi araştırmak için.
- Numune: plazma
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 2000-2500 x g (RCF) (10-15 dakika/25 oC)

Vacufine®

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

VACUFINE SEDİMENTASYON TÜPLERİ

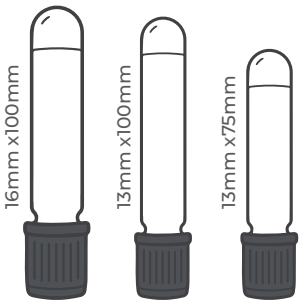



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
527116	1,6	13x75	Sodyum Sitrat (0,129M)	PET	Kağıt
527124	2,4	13x75	Sodyum Sitrat (0,129M)	PET	Kağıt
587116	1,6	13x75	Sodyum Sitrat (0,109M)	PET	Kağıt
587124	2,4	13x75	Sodyum Sitrat (0,109M)	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Akrilik bazli jel ve pulvarizasyon tekniği ile kaplanarak kurutulmuş pıhtı aktivatörü içerir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25°C)

www.makrolabkonya.com.tr

VACUFINE **LİTYUM/SODYUM HEPARİN** TÜPLERİ

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
707120	2	13x75	Lityum Heparin	PET	Kağıt
707220	2	13x75	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
727140	4	13x75	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Kağıt
727240	4	13x75	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Şeffaf
707140	4	13x75	Lityum Heparin	PET	Kağıt
707240	4	13x75	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
728160	6	13x100	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Kağıt
728260	6	13x100	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Şeffaf
708160	6	13x100	Lityum Heparin	PET	Kağıt
708260	6	13x100	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
709190	9	16x100	Lityum Heparin	PET	Kağıt

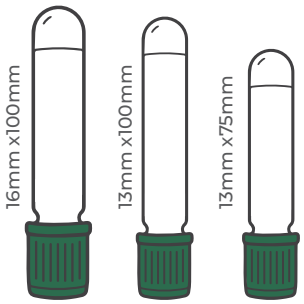



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile tüpe kaplanmış 17 IU/mL heparin, antitrombin üzerinden pıhtılaşmayı önlemektedir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Numune: heparin plazması.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: ≤1300 x g (RCF) (10 dakika/25 °C)

Vacufine®

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

VACUFINE **PLAZMA AYIRICI** TÜPLERİ

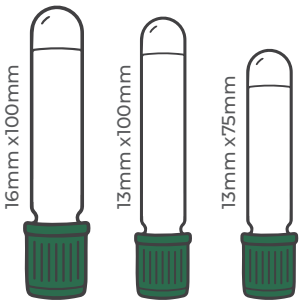



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
757130	3	13x75	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt
757230	3	13x75	Lityum Heparin/Jel	PET	Şeffaf
758145	4,5	13x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt
758245	4,5	13x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Şeffaf
759180	8	16x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile tüpe kaplanmış 17 IU/mL heparin, antitrombin üzerinden pıhtılaşmayı önlemektedir. İnert bir jel içermektedir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Plazma örneği ayırmak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

VACUFINE **PLAZMA PREPERASYON** TÜPLERİ

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
608150	5	13x100	K2EDTA/Jel	PET	Kağıt
608250	5	13x100	K2EDTA/Jel	PET	Şeffaf
609185	8,5	16x100	K2EDTA/Jel	PET	Kağıt

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme ile kaplanmış EDTA ve inert bir jel içermektedir.
- Viral yük tayini, moleküler analizler için kullanılabilir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Seyreltilmemiş numune gerektiği durumlarda seyreltilmemiş plazma örneği elde etmek için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1100-1500 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)

Kapak Rengi

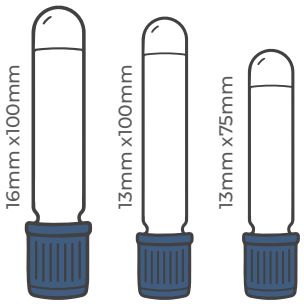



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Vacufine®

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

VACUFINE **GLUKOZ** TÜPLERİ

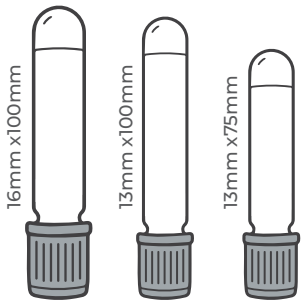



Ambalaj **100** Adet

Koli (Karton) **1.000** Adet

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
807120	2	13x75	NaF Na2EDTA	PET	Kağıt
807220	2	13x75	NaF Na2EDTA	PET	Şeffaf
807140	4	13x75	NaF Na2EDTA	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Florür / EDTA içerir
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Florür, glikoliz inhibisyonuna yol açmaktadır. Laktat, glukoz ve HbA1c ölçümlerinin daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tercih edilir.
- Numune: Plazma
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: ≤1300 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)

SAĞLIĞINIZ
Bizimle Birlikte
Güvende

KAN ALMA İĞNELERİ

HOLDER

TIBBİ ATIK KOVASI

makrolab

MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

www.**makrolabkonya**.com.tr

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

Katalog No.	Ürün Adı	Gauge	Boyut (inç)
990206	Kan Alma İğnesi	21G	1 1/4"
990208	Kan Alma İğnesi	22G	1 1/4"
990218	Güvenlikli Kan Alma İğnesi	21G	1 1/4"
990220	Güvenlikli Kan Alma İğnesi	22G	1 1/4"
990228	Kelebek Set	21G	3/4"

VACUFINE
PLAZMA PREPERASYON ve PRP
TÜPLERİ

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Vacufine®

VACUFINE **PLAZMA AYIRICI** TÜPLERİ

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (Litre)
990102	Holder	
990205	Turnike	
997015	Katı Atık Kabı	1,5
997030	Katı Atık Kabı	3,0
997050	Katı Atık Kabı	5,0
997075	Katı Atık Kabı	7,5

SAĞLIĞINIZ
Bizimle Birlikte
Güvende

makrolab

MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Urifine

www.**makrolabkonya**.com.tr

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Urifine

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (ml)	Ambalaj
992101	İdrar Kabı (Non-steril)	100	800
992102	İdrar Kabı (Aseptik Steril)	100	300
992103	İdrar Kabı (Gama Steril)	100	300
994300	24 Saatlik İdrar Kabı (Non steril)	3000	30
909002	Düz Tüp Kapağı 16x100		1000
909001	Kanatlı Tüp kapağı		1000

URİFİNE
İDRAR TAŞIMA
KAPLARI

VACUFINE
GAİTA BALGAM
TAŞIMA KAPLARI

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (ml)	Ambalaj
991001	Kaşıklı Gaita Kabı (Non-steril)	10	2000
995002	Vida Kapaklı Gaita Kabı (Non-steril)	50	1000
995003	Balgam Taşıma Kabı (Non-steril)	50	1000

www.makrolabkonya.com.tr

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Urifine

URİFİNE **VAKUMLU İDRAR** TÜPLERİ

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
908160	6	13x100	Katkısız	PET	Kağıt		100/1000
909190	9	16x100	Katkısız	PET	Kağıt		100/1000

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
949180	8	13x100	Kloroheksidin	PET	Kağıt		100/1000
949110	10	16x100	Kloroheksidin	PET	Kağıt		100/1000

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
907140	4	13x100	Borik Asit	PET	Kağıt		100/1000
938160	6	16x100	Borik Asit	PET	Kağıt		100/1000
909110	10	16x100	Borik Asit	PET	Kağıt		100/1000

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Santrifüj Tüpü	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
909010	10	16x100	Santrifüj Tüpü	PP	Şeffaf		3000

VACUFINE
ENTEGRE İDRAR TAŞIMA KAPLARI

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim	Ambalaj
991101	Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Non-steril)	100	400
991102	Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Aseptik Steril)	100	300
995300	24 Saatlik Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Non Steril)	3000	16
991103	İdrar Kabı (Vakumlu Tüpe Uygun) Steri	100	300

makrolab
MAKROLAB TIBBİ ÜRÜNLER A.Ş.

Yüksekliği Ayarlanabilir Perde Sistemi

Mukavemetli saf aliminyum ekstrüzyon malzemeden üretilmiştir. Teleskopik sistem sayesinde tavan yüksekliği istenilen ölçüde ayarlanabilmektedir. Eloksal kaplama ile korozyona karşı güçlendirilmiştir.

Yüksekliği Ayarlanabilir Perde Sistemi

Mukavemetli saf aliminyum ekstrüzyon malzemeden üretilmiştir. Sağ ve sol duvar formlarına kendi içerisinde katlanarak minimum alan kaplamaktadır. Eloksal kaplama ile korozyona karşı güçlendirilmiştir.

YÜKSEKLiĞi
AYARLANABiLiR
PERDE SiSTEMi

ZEBRA PERDE
STOR PERDE

Zebra Perde

Ürünlerimiz ISO 9001;2000 standart belgeli kumaş ve mekanizma sistemleri TSE belgeli kumaşlar lazer kesim kapalı kasa ve açık kasa seçenekleri mevcuttur.

Stor Perde

Ürünlerimiz ISO 9001;2000 standart belgeli kumaş ve mekanizma sistemleri TSE belgeli kumaşlar lazer kesim kapalı kasa ve açık kasa seçenekleri mevcuttur.

Her örnek bir hayattır,

Hassasiyetimizle Koruyoruz.

makrolab

Makrolab Tıbbi Ürünler A.Ş.

A. Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Özl. San.
10645. Sokak No:17
Karatay / Konya / TÜRKİYE

T. +90 332 353 87 88

F. +90 332 353 87 90

W. makrolabkonya.com.tr

M. info@makrolabkonya.com.tr